



**ASSELUM
LUMINOTÈCNICS, SL.**

✉ info@asselum.com

☎ +34 937 25 98 10



MAVOLUX 5032 C BASE
Luxómetro de alta precisión

MAVOLUX 5032 C BASE


El luxómetro de alta precisión



Luxómetro profesional de Clase C según DIN 5032-7, UNE EN 13032-1, Apéndice B y la CIE 69. El excelente ajuste $V(\lambda)$ y la corrección del coseno permiten una medición fiable de la luz natural y de todas las fuentes de luz artificiales, incluidas los LED.


Los cuatro rangos de medida, de conmutación automática o manual, cubren de 0,1 lx a 199900 lux con una precisión de más de 3% y una respuesta espectral $V(\lambda)$ $f_1' < 7,5\%$

Sensibilidad del brillo espectral del ojo humano $V(\lambda)$

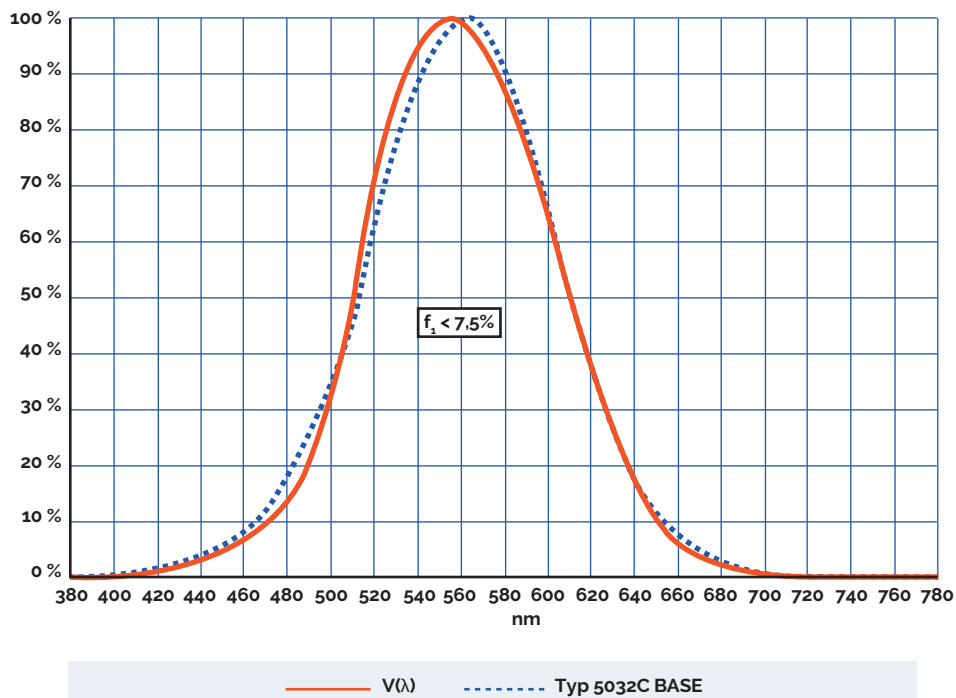

Incluido en el suministro:

- > Pila
- > Manual de instrucciones
- > Protocolo de calibración

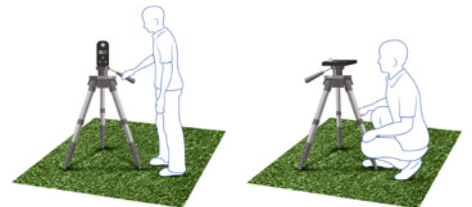

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Iluminancia	0,1 lx ... 199 900 lx / 0,01 fc ... 19990 fc
Sensor de medición	Fotodiodo de silicio con filtro $V(\lambda)$
Limite de error - ajuste $V(\lambda)$ (f_1') típico	< 7,5 %
Limite de error - Error total típico	≤ 15 %
Batería	1,5V mignon, AA